

アルドステロン 検査方法変更のお知らせ

このたび、表題の検査項目（外注）について、検査方法・基準値等を変更させていただきます。
診療科のみなさまには、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

2021年 3月 1日（月） 受託分より

- 内容変更となる検査項目：アルドステロン
- 検査場所：LSIメディエンス（外注）
- 変更点の概要

検査項目	変更内容	新		旧	
アルドステロン	検査方法	CLEIA		RIA（チューブ固相法）	
	検体	血清・尿		同左	
	保存方法	凍結		同左	
	基準値	血液	随時：170.0 pg/mL 以下		随時：36 - 240 pg/mL 臥位：30 - 159 pg/mL 立位：39 - 307 pg/mL
		尿	10 µg/day 以下		同左
	報告桁数	小数第1位		整数	
	所要日数	血液	2～3日		同左
尿		3～5日		同左	

● 備考

採血時刻・安静度・体位によって測定値に差が出ますので、早朝空腹時30分間安静後の採血を推奨します。

検査部サポートライン（PHS：2147）

検査部：中西（PHS：6204）・増田（PHS：2144）・西山（PHS：2141）




アルドステロン 検査方法変更のお知らせ


[2/2]

サポートライン
2147

● 新旧の相関

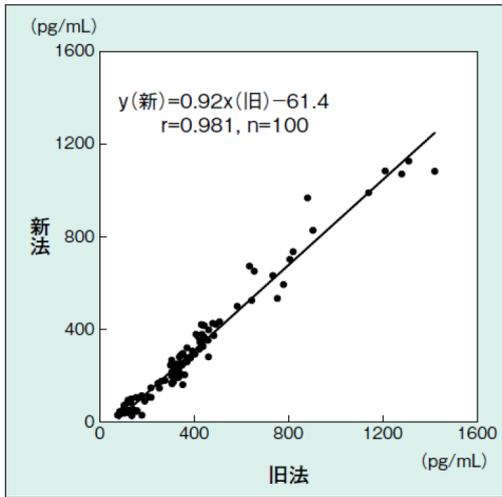

血液

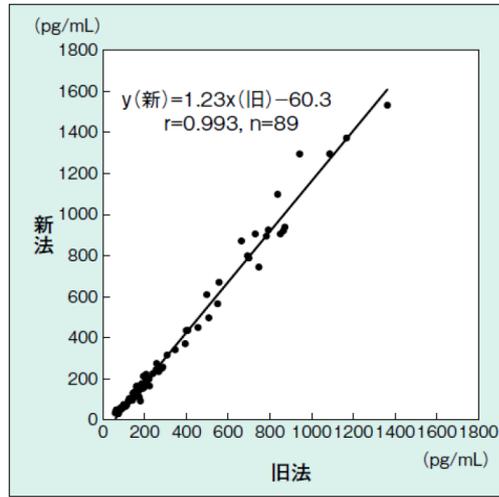

尿

LSIメディエンス検討

● 報告形態

CLEIA測定値に、42.3を加算するとRIA値相当となります。

変更後、1ヶ月間は新旧の検査結果を報告いたします（血液のみ）。

検体検査結果 00000000 動作検証用患者

採取日時: 2021-02-26 採取時刻: 13:47 依頼科: 検受 依頼医師: 透析: 無
材料コメント: 番号: 21022609003

内分泌関連検査	
血液	
アルドステロン[CLEIA]	150
アルドステロン	190

検査部コメント: 結果値コメント: 基準値: 印刷: 閉じる

