

診療科各位殿


平成 23 年 8 月 26 日
検査部システム部門
検査部長 一山 智

便中ヘモグロビン(便へモ)測定機器の変更等について

平成 23 年 9 月 5 日より、便へモの測定機器を NS-1000 から NS-Plus に変更します。
それに伴い以下の点を変更します。

1. 参考正常値を 40ng/mL 以下から 100ng/mL 以下に変更します。
2. 採便容器を透明の緩衝液タイプから青色の緩衝液タイプに変更します。
3. バーコードラベルの貼る場所を袋から容器本体に変更します。

NS-1000 と NS-Plus の相関

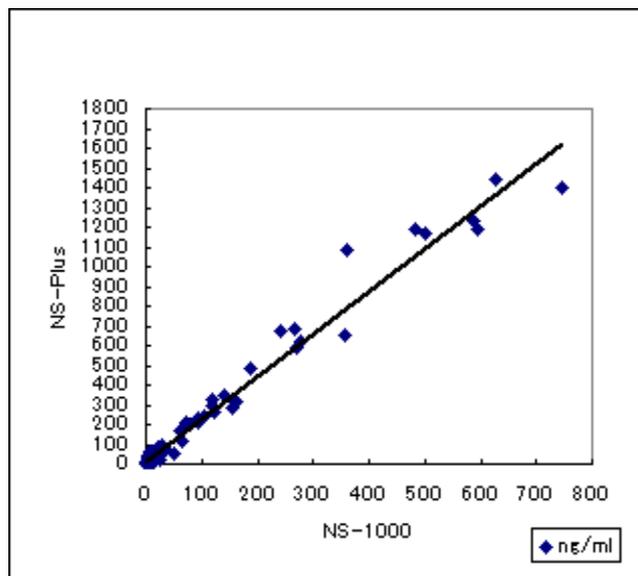

例数 N=100
相関係数 $r=0.9795$
回帰式 $Y=2.1614+14.004X$


旧容器



新容器



ラベル正面

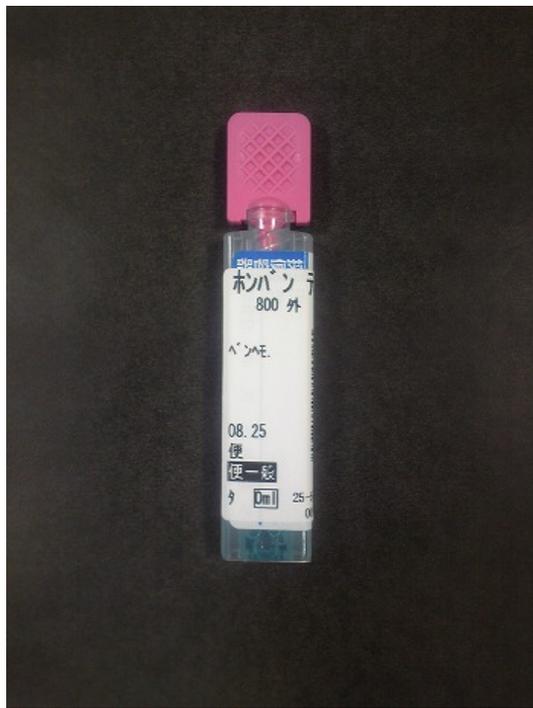

ラベル側面

