
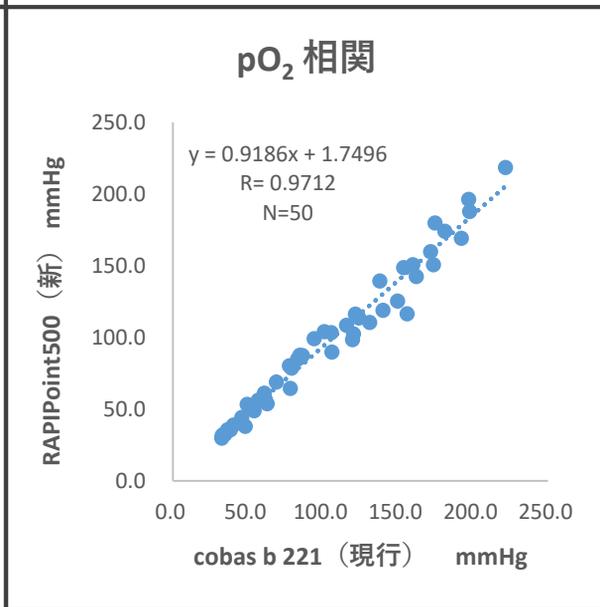
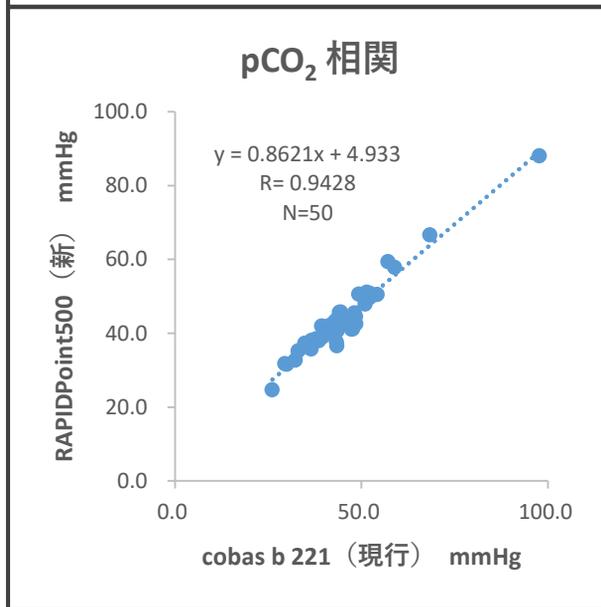





血液ガス相関 (RAPIDPoint500 vs cobas b 221)

酸塩基平衡


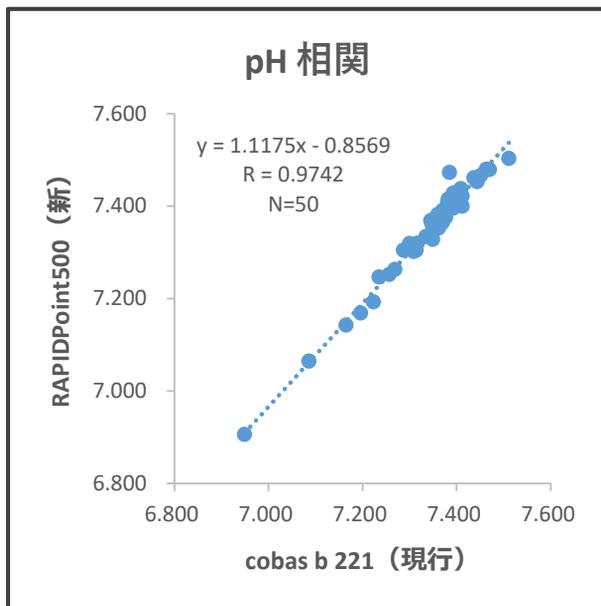


血液ガス相関 (RAPIDPoint500 vs cobas b 221)

電解質

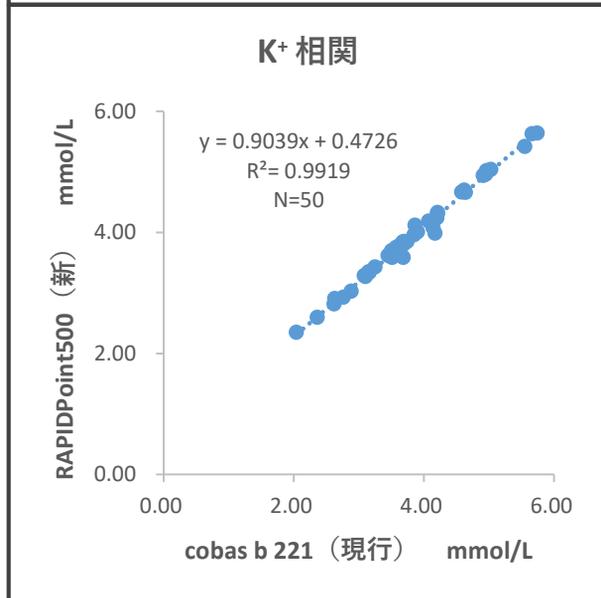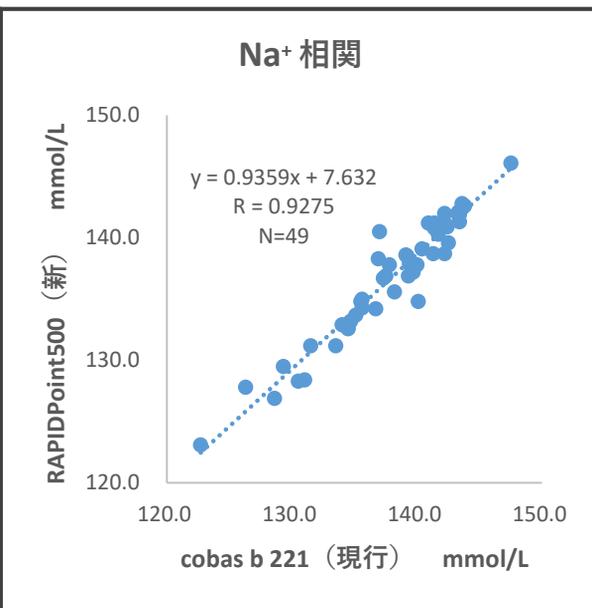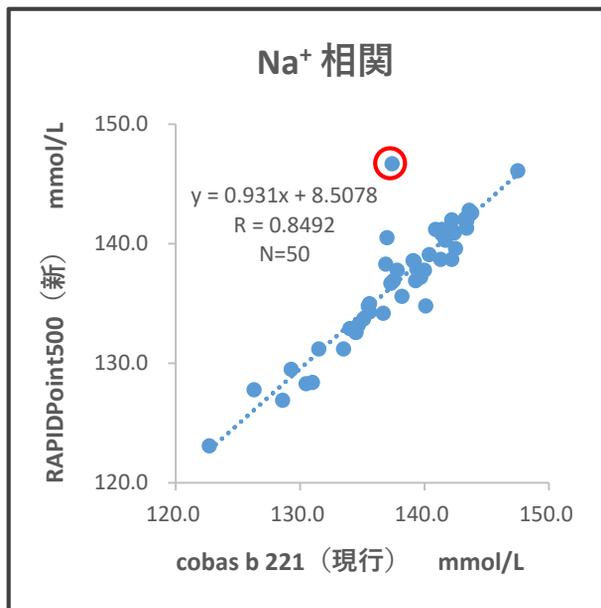


「Na⁺」相関で“137.4, 146.7”と乖離データが1件あるが、心カテーテル後の抗凝固剤の影響によるものと思われる。
ただし、両方とも参考値内ではある。
乖離検体を抜いて相関図を作成したものが右図である。

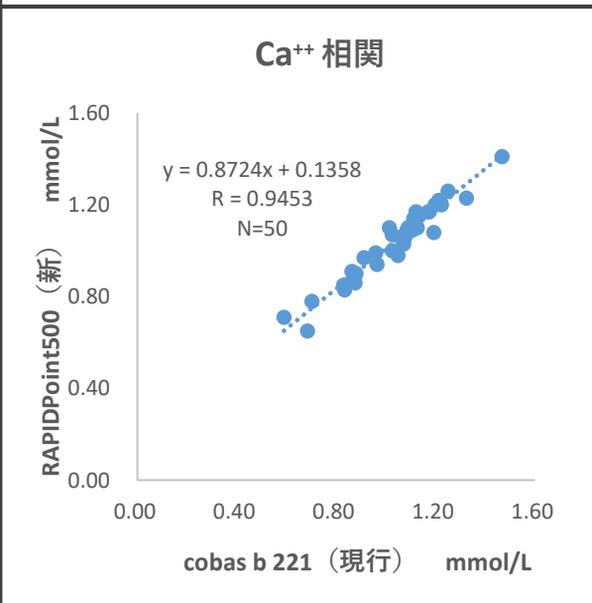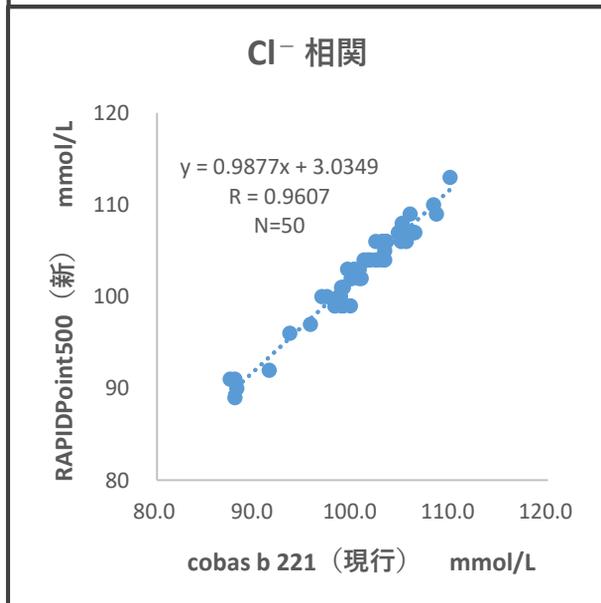

血液ガス相関 (RAPIDPoint500 vs cobas b 221)

代謝項目

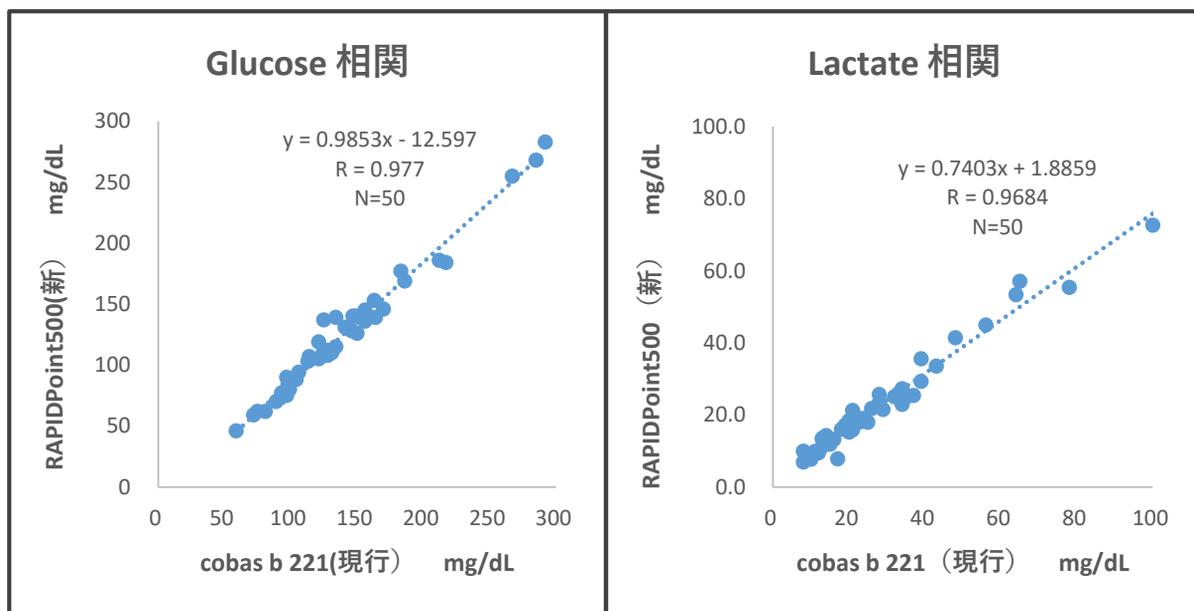

CO-oximetry

