


TSH刺激性レセプター抗体 (TSAb)

TSH刺激性レセプター抗体 (TSAb) の測定試薬を同一メーカーが販売するnon-RIA試薬に変更致します。新法採用により感度および特異性が向上し、未治療バセドウ病、バセドウ病再発での診断精度が向上致します。


本変更に伴い、基準値をメーカー推奨基準値に変更致します。

新旧二法の相関

[全体]

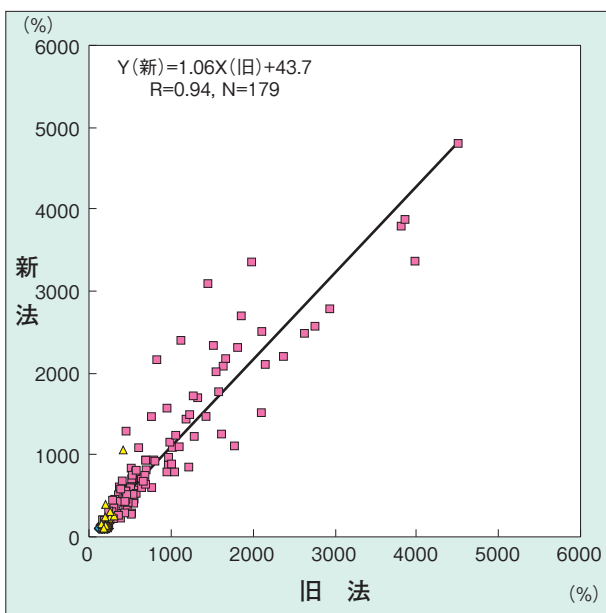

[低値域]

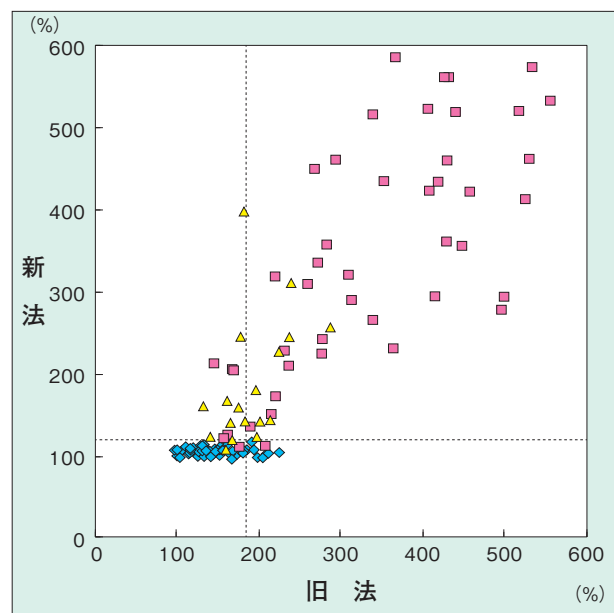

■ …未治療バセドウ病 ▲ …バセドウ病再発 ◆ …健常人

(メーカー検討データ)

参考文献

上條桂一, 他: 医学と薬学, 71(5), 903~911, 2014.