血液ガス分析装置 Rapidpoint500
測定方法

①到着確認を行って下さい。

②  シリンジアイコンの確認と、

項目が ~~PO2~~ ~~PO2~~ になっていない事を確認して下さい。

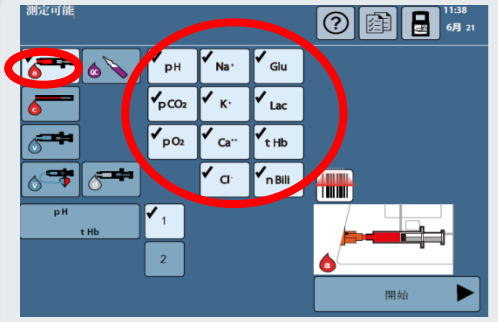

③シリンジを挿入して下さい。

＊自動吸引されますので圧入は不要です

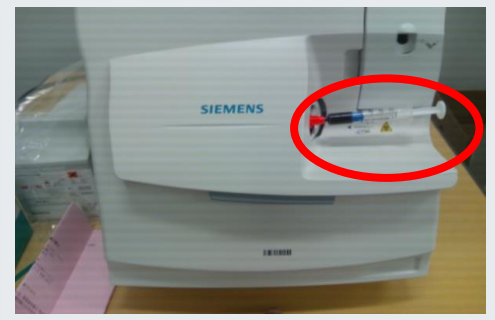

④  を押して測定を開始して下さい。

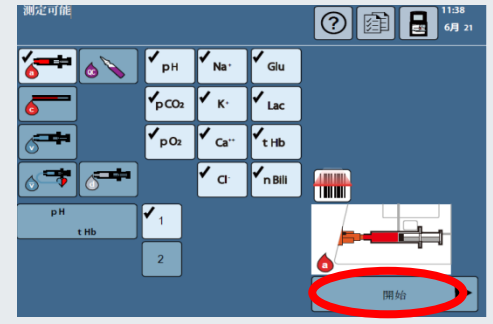

⑤右画面になったら、検体吸引完了です。

シリンジを取り外し を押して下さい。

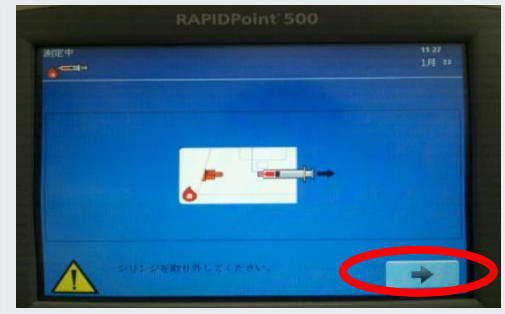

⑥バーコードを読み取り後 (Key入力可能)

を押して下さい。

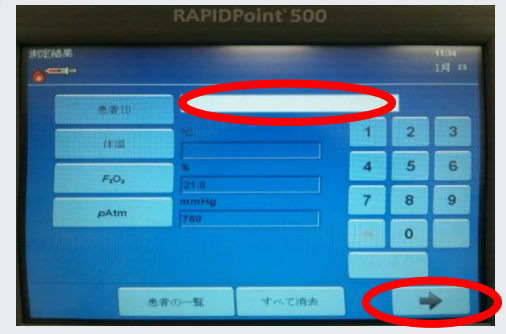
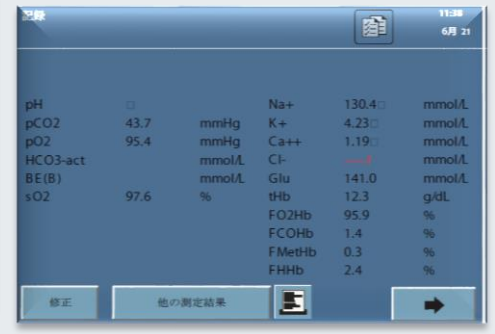
⑦測定結果が表示されます。